

Kalibrierprotokoll DLV SF-586a/b

Geräte-Nr.:
Sensor-Nr.:

Prüfstand

Freistrahlfeld Windkanal Westenberg Engineering

Hersteller: Westenberg Engineering

Meßbereich: 0,5 - 65 m/s


Pitot-Pohr mit Druckkalibrierung System PTE-1

Hersteller: Heise

Meßbereich: 0,0 - 4 mbar, 0,0 - 40 mbar

Auftrags-Nr.:

DLV SF-586a Nm/s	PTE-1 Nm/s	Fehler (MW) %
0,00	0,00	0,00
1,67	1,67	0,22
2,70	2,71	-0,17
4,16	4,14	0,53
6,28	6,26	0,29
9,36	9,33	0,29
13,97	13,90	0,46
20,41	20,36	0,22
28,91	28,90	0,03
40,08	40,08	-0,02
57,63	57,63	0,00

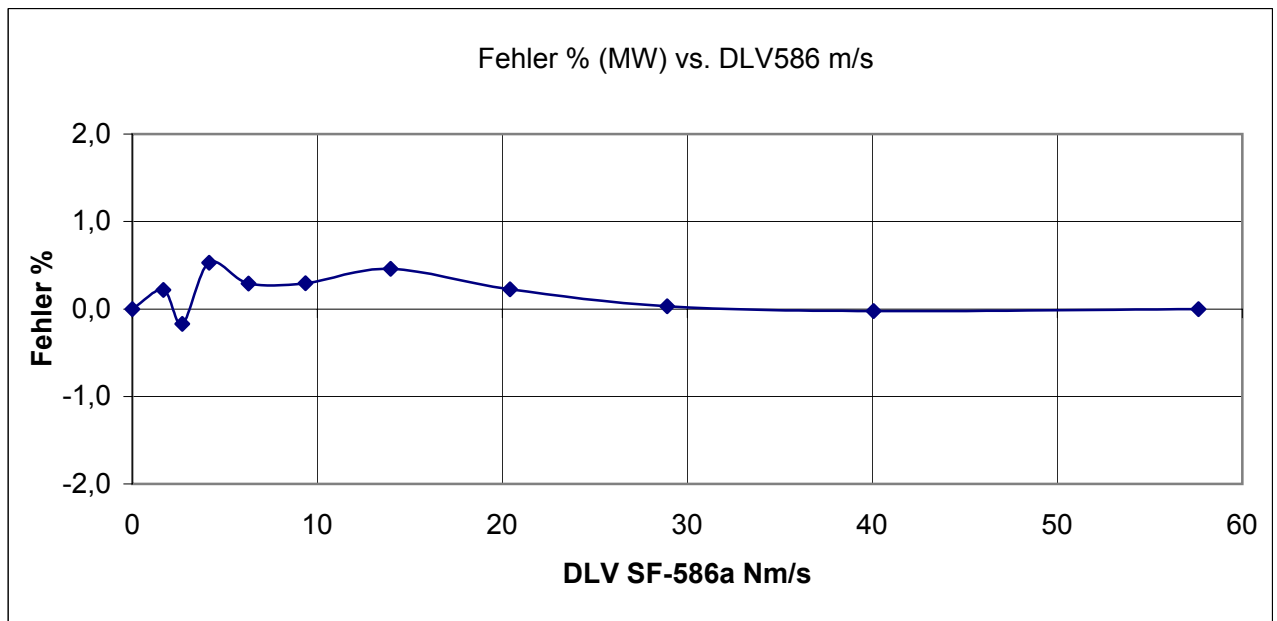

Datum	Name	Unterschrift